


Газоанализаторы АНКAT-410. Внешний вид

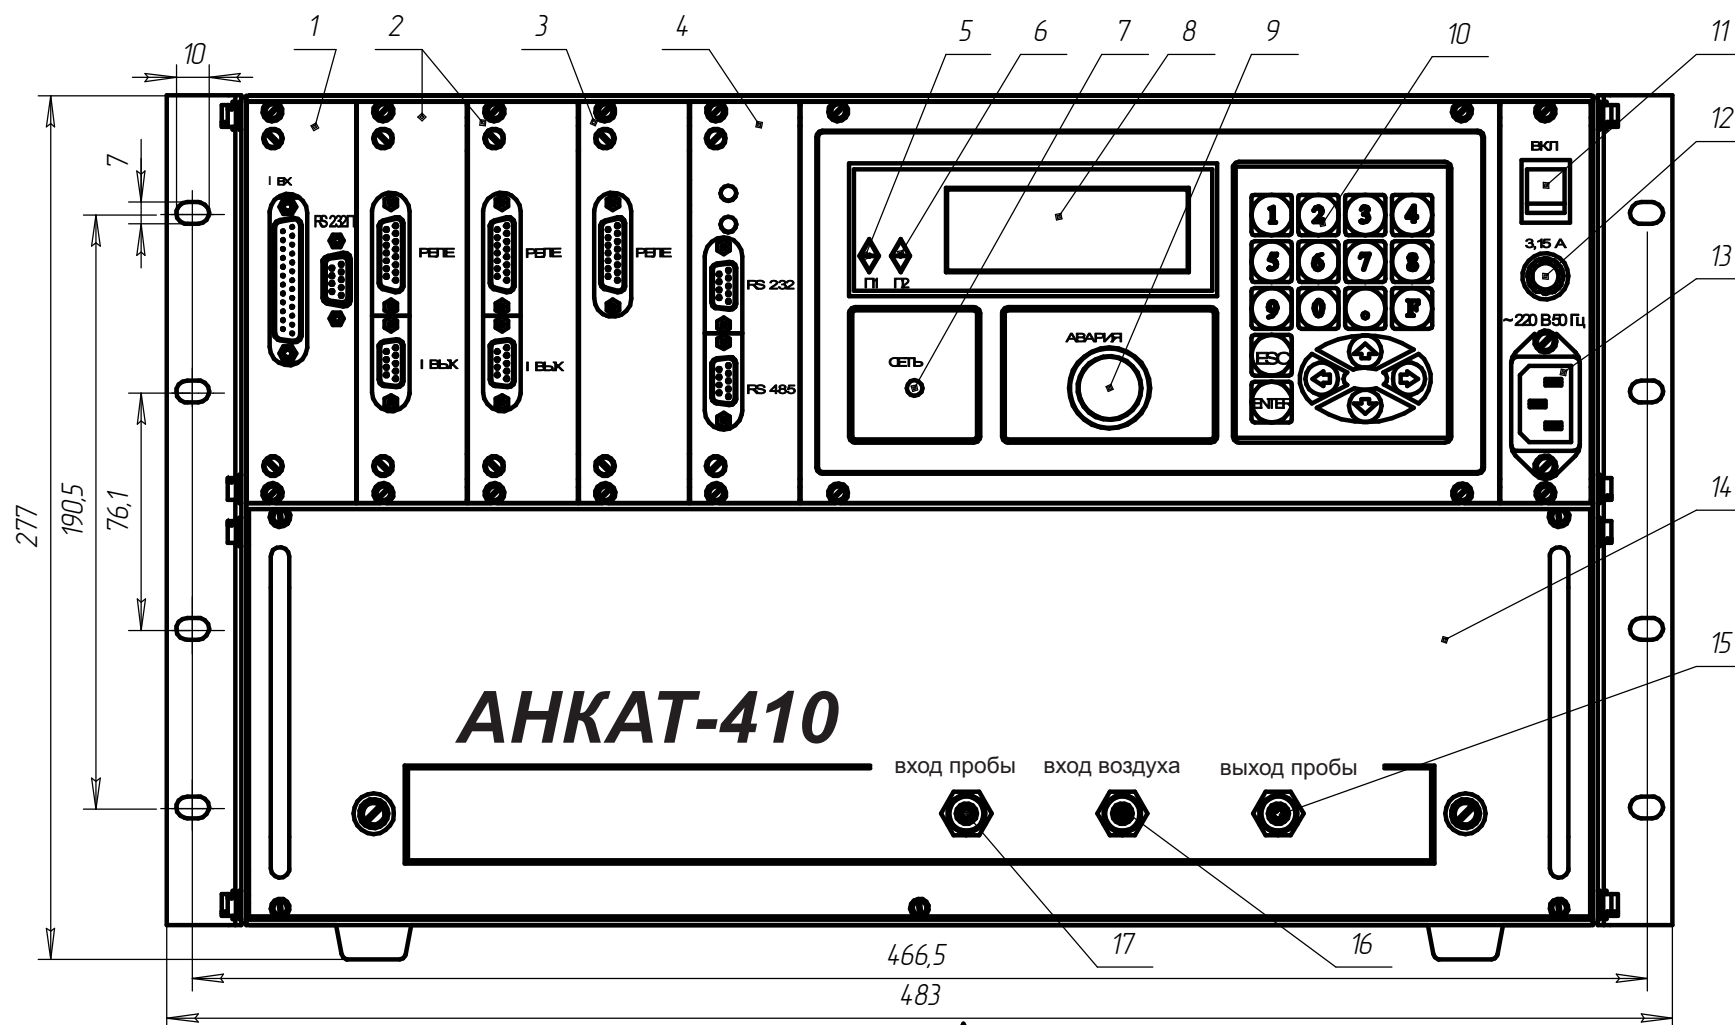


- 1 – модуль коммутации;
- 2 – устройства РТВ;
- 3 – устройства РТВ;
- 4 – адаптер интерфейса;
- 5 – индикаторы на превышение Δ или принижение ∇ "П1" ("Порог 1");


- 6 – индикаторы на превышение Δ или принижение ∇ "П2" ("Порог 2");
- 7 – индикатор СЕТЬ;
- 8 – жидкокристаллический индикатор;
- 9 – источник звуковой сигнализации "АВАРИЯ";
- 10 – клавиатура;
- 11 – переключатель "ВКЛ";

- 12 – вставка плавкая "3,15 А";
- 13 – вилка сетевая "~ 220 В, 50 Гц";
- 14 – модуль первичных преобразователей;
- 15 – штуцер "ВЫХОД ПРОБЫ";
- 16 – штуцер "ВХОД ВОЗДУХА";
- 17 – штуцер "ВХОД ПРОБЫ".


Газоанализатор АНКAT-410. Схема электрическая внешних соединений

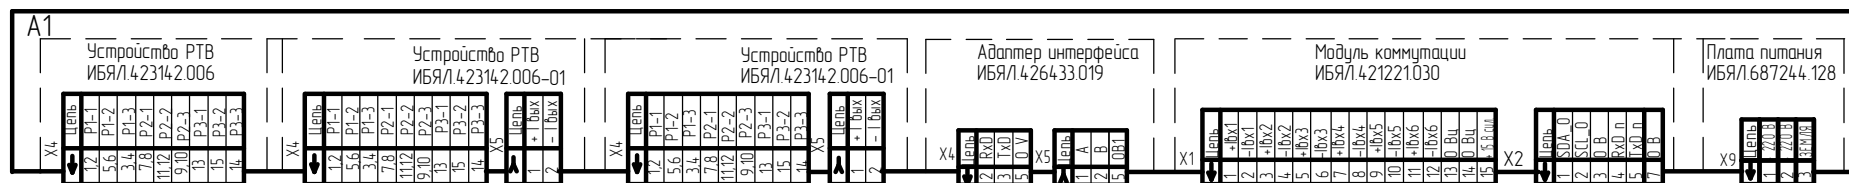


Шкафы пробоподготовки ШПП-410 ИБЯ/Л.422419.009 для установки внутри помещений.
Схема газовая соединений

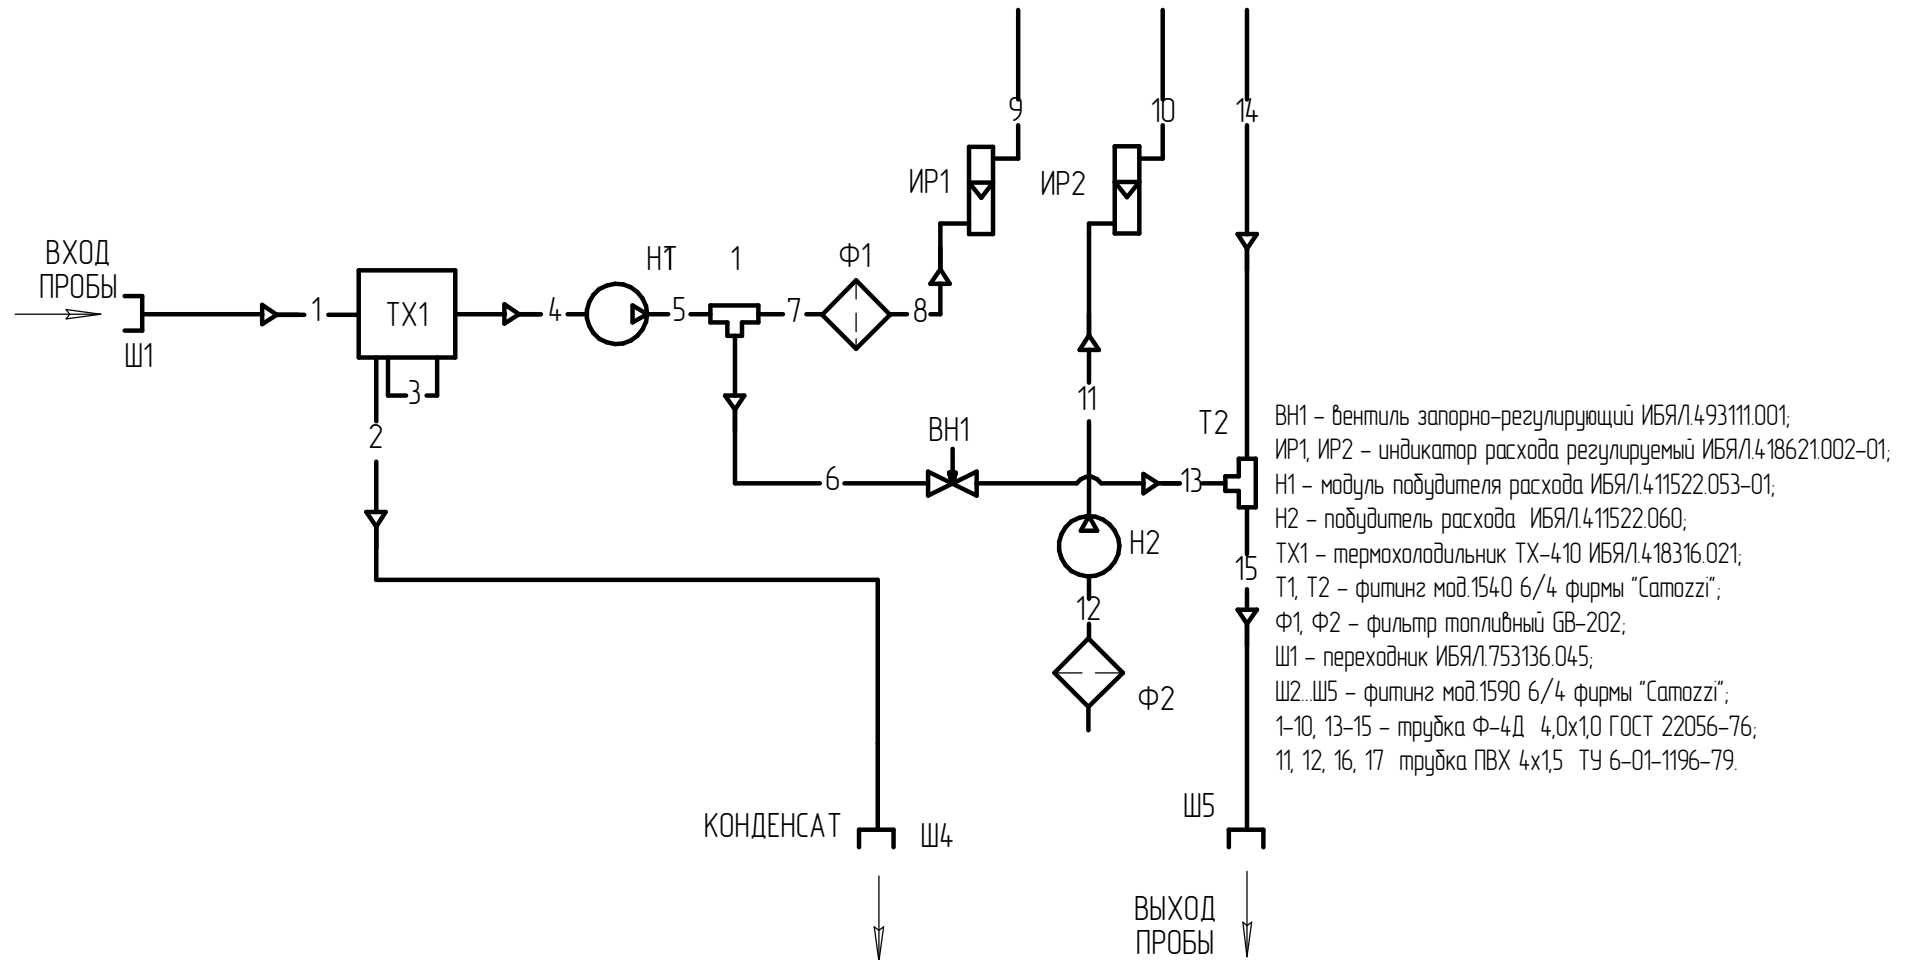


Шкафы пробоподготовки ШПП-4.10 ИБЯ/Л.4224.19.009-01 для установки открытых площадках.
Схема газовая соединений

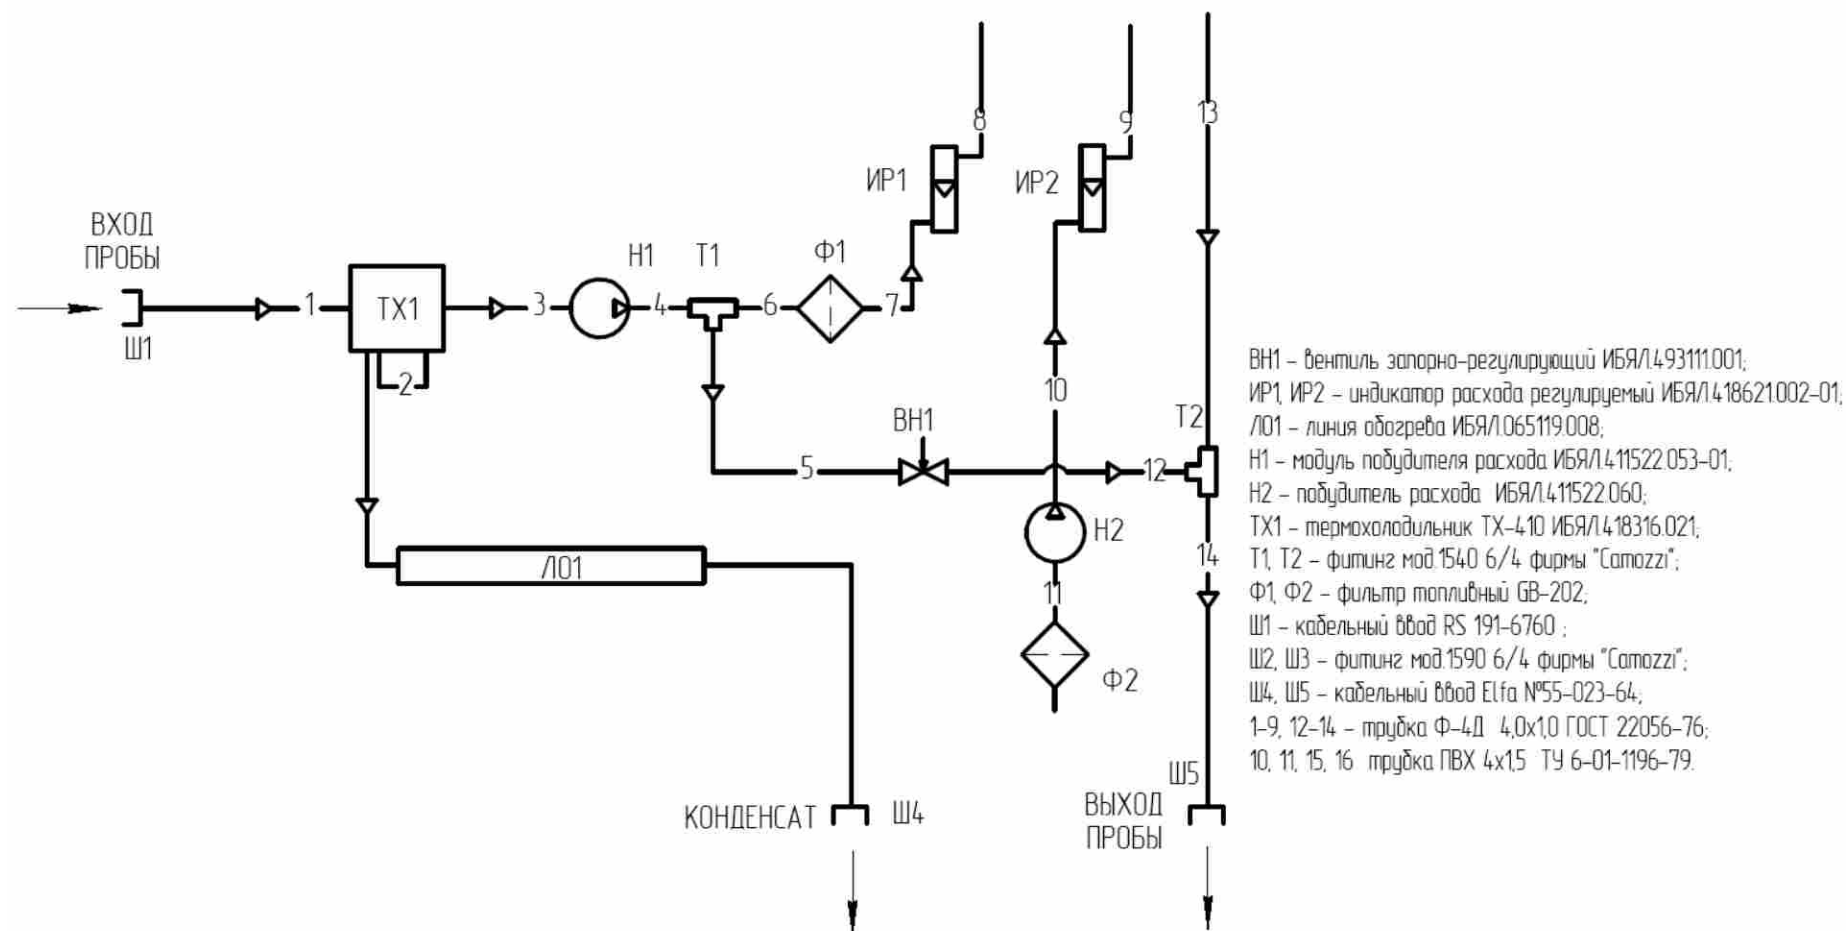

Шкафы пробоподготовки ШПП-410 ИБЯЛ.422419.009-02 для измерения содержания HCl и Cl_2
(для установки внутри помещений). Схема газовая соединений

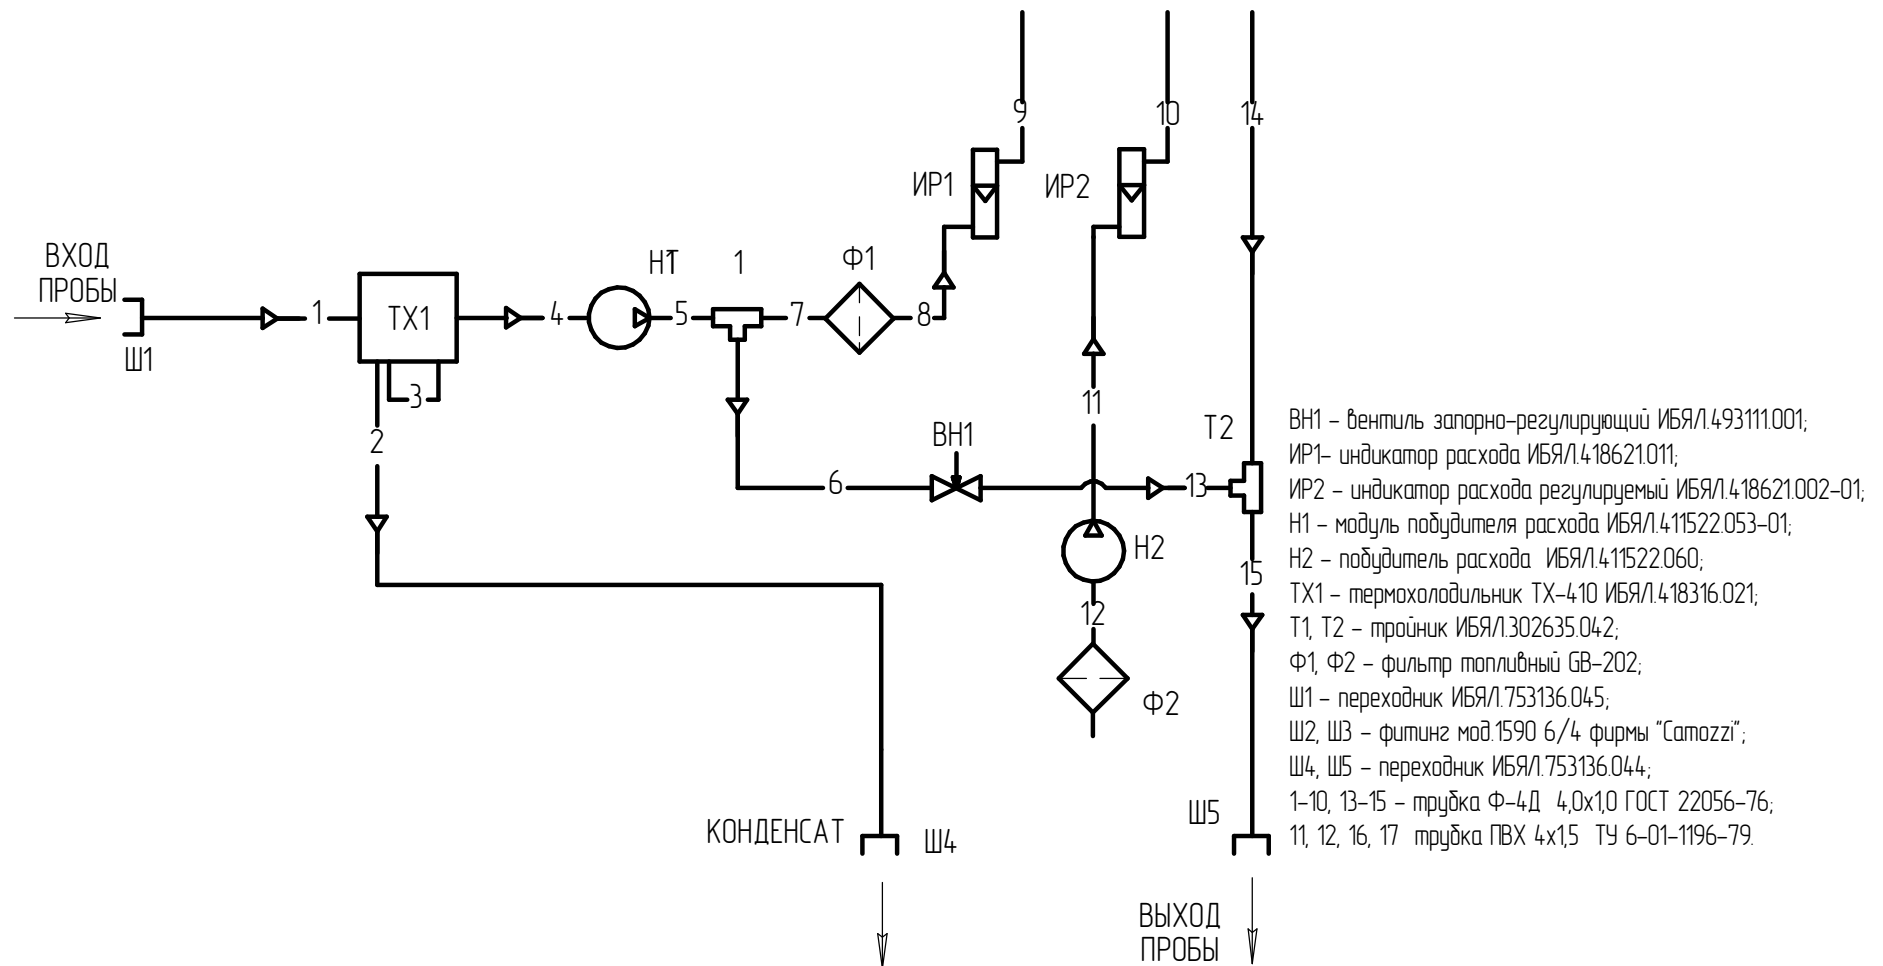

Шкафы пробоподготовки ШПП-4.10 ИБЯ/Л.422419.009-03 для измерения содержания HCl и Cl_2
(для установки на открытых площадках). Схема газовая соединений

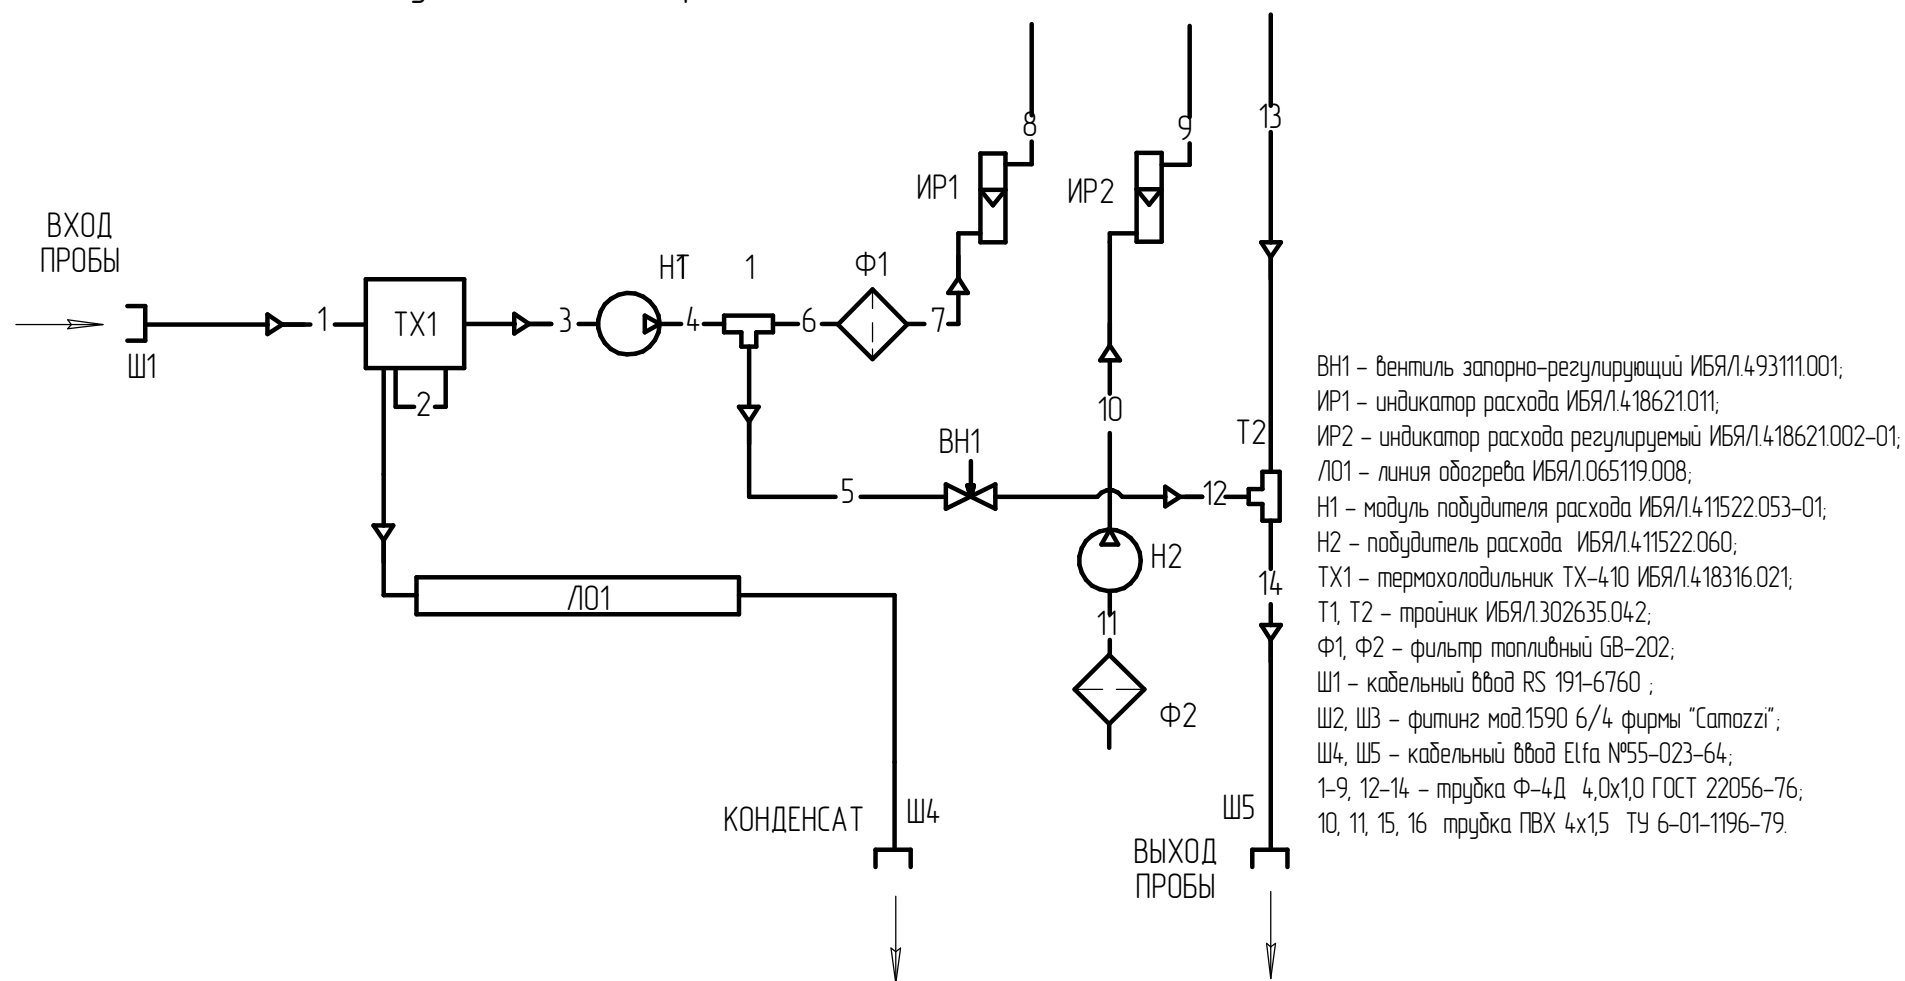

Шкафы пробоподготовки ШПП-410. Схема электрическая внешних соединений

Рисунок 1


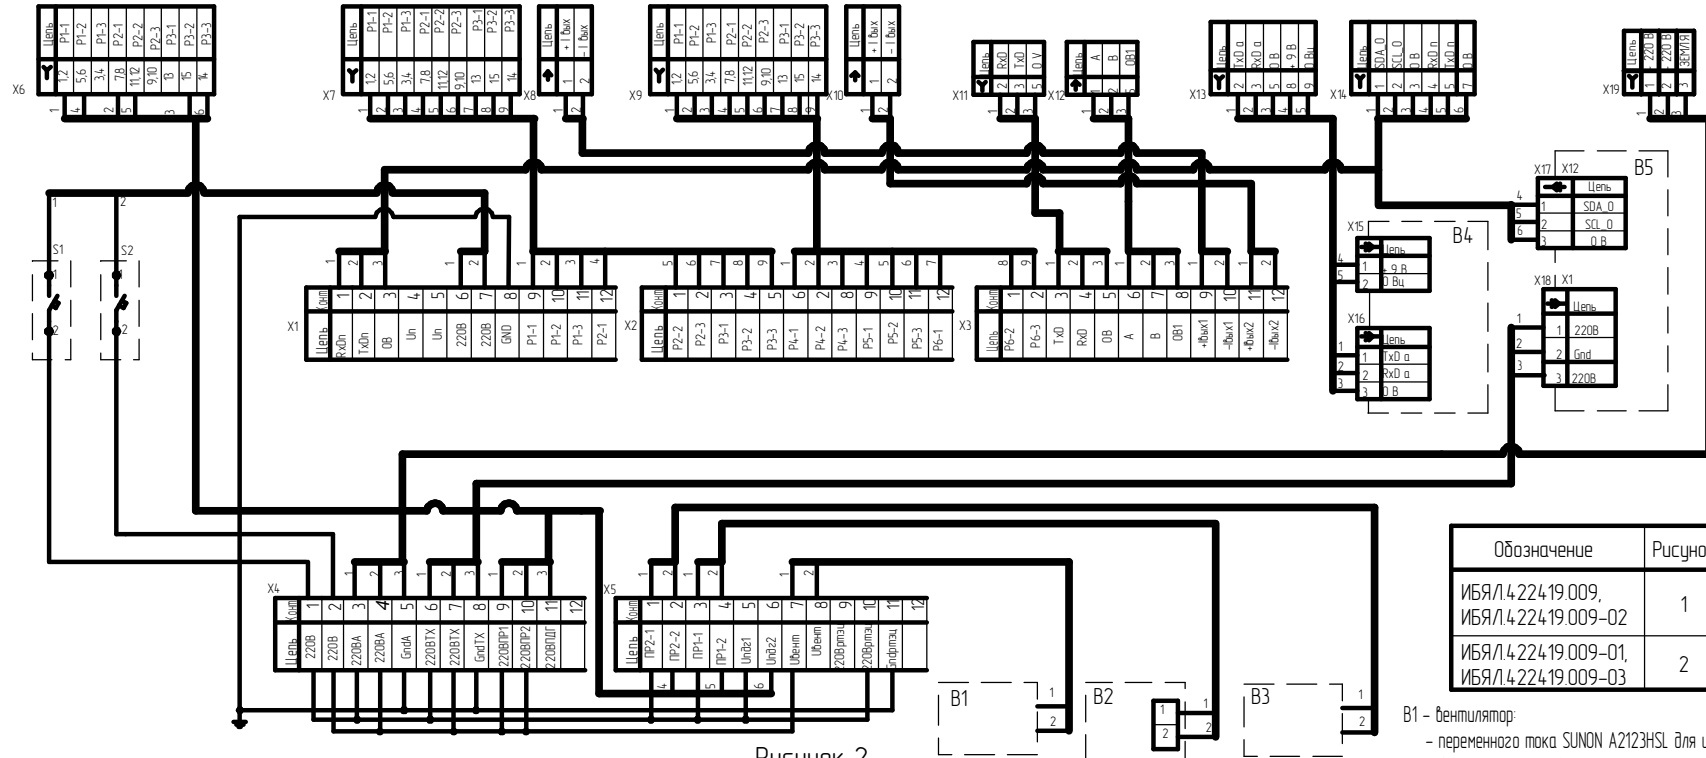


Рисунок 2

остальное – см. рис.1

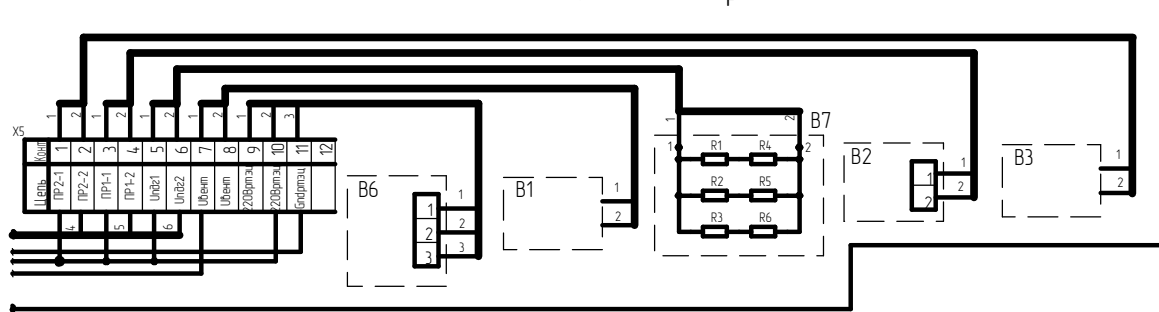

Обозначение	Рисунок
ИБЯ/Л4.224.19.009, ИБЯ/Л4.224.19.009-02	1
ИБЯ/Л4.224.19.009-01, ИБЯ/Л4.224.19.009-03	2

В1 – вентилятор:

– переменного тока SUNON A2123HSL для исполнений
ИБЯ/Л4.224.19.009, ИБЯ/Л4.224.19.009-02;

– фильтрующий SK 3332.100 для исполнений
ИБЯ/Л4.224.19.009-01, ИБЯ/Л4.224.19.009-03;

В2 – компрессор SCHEGO Optimal;

В3 – модуль поддителя расхода;


В4 – дифференциальный цифровой манометр ДМЦ-01М с RS-232;

В5 – термохолодильник TX-4-10;


В6 – регулятор температуры электронный цифровой РТЭЦ-220/2,25
для исполнений ИБЯ/Л4.224.19.009-01, ИБЯ/Л4.224.19.009-03;

В7 – плата нагревателя ИБЯ/Л687244.176 для исполнения
для исполнений ИБЯ/Л4.224.19.009-01, ИБЯ/Л4.224.19.009-03.


Шкаф пробоподготовки ШПП-410. Внешний вид (со снятой дверью и установленным газоанализатором АНКAT-410)

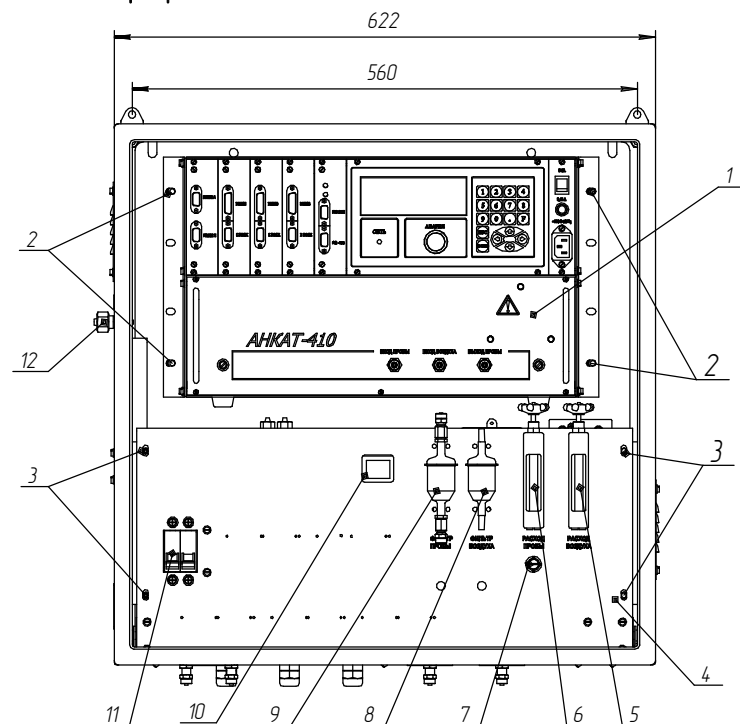

Вид снизу

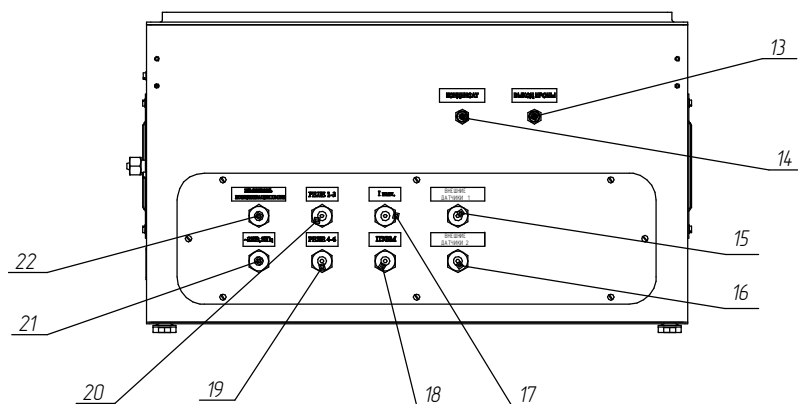

Вид сбоку

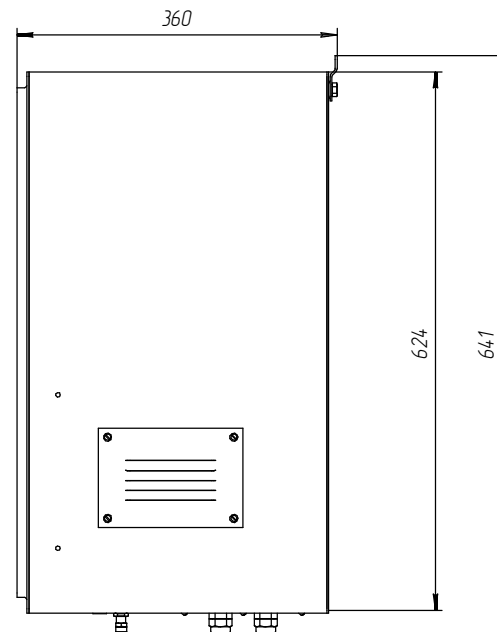

- 1 – газоанализатор АНКAT-410;
- 2 – винты для крепления газоанализатора АНКAT-410;
- 3 – винты для крепления панели;
- 4 – панель;
- 5 – индикатор расхода регулируемый "РАСХОД ВОЗДУХА";
- 6 – индикатор расхода регулируемый "РАСХОД ПРОБЫ";
- 7 – вентиль запорно-регулирующий;
- 8 – фильтр воздуха "ФИЛЬТР ВОЗДУХА";
- 9 – фильтр пробы "ФИЛЬТР ПРОБЫ";
- 10 – окно для наблюдения за индикатором термохолодильника;
- 11 – выключатель "Щит" ВА 1Р 10А (автомат защитного отключения);
- 12 – штуцер "ВХОД ПРОБЫ";
- 13 – штуцер для сброса пробы "ВЫХОД ПРОБЫ";
- 14 – штуцер для слива конденсата "КОНДЕНСАТ";
- 15 – кабельный вход для подключения внешних датчиков "ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ 1";
- 16 – кабельный вход для подключения внешних датчиков "ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ 2";
- 17 – кабельный вход для подключения токового выхода "I вых";
- 18 – кабельный вход для подключения ПЭВМ "ПЭВМ";
- 19 – кабельный вход для подключения реле "Реле 4-6";
- 20 – кабельный вход для подключения реле "Реле 1-3";
- 21 – кабельный вход для подключения напряжения питания "~ 220 В, 50 Гц";
- 22 – кабельный вход для подключения измерителя концентрации пыли "ИЗМЕРИТЕЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ".